

1. О ДАННОМ КРАТКОМ РУКОВОДСТВЕ




Данное краткое руководство не заменяет полноценной инструкции по эксплуатации. Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства!

Некоторые вышеописанные функции могут отличаться от фактических из-за индивидуальных настроек.

2. ОПИСАНИЕ

Устройства MA 25 / MA 25e / MA 27 / MA 27e представляют собой аудиометры для тональной аудиометрии с воздушным звукопроведением. В устройствах MA 25e и MA 27e к функциям MA 25/MA 27 добавлен автоматический тест порога слышимости Хьюсона-Вестлейка, а также функции микрофона врача и передачи результатов на ПК.

3. ФУНКЦИИ И КНОПКИ

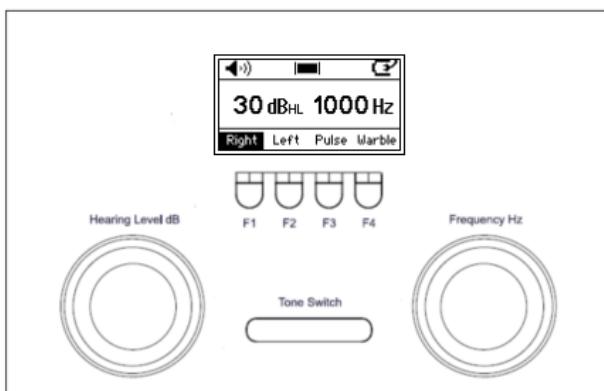

Название (я)/функция (-и)	Описание
Включение	Нажмите Tone Switch (переключатель тона) Внимание! Подавать питание на устройство разрешается, только если наушники подсоединенны!
Выключение	Нажмите регулятор Hearing Level dB (Порог слышимости, дБ) и регулятор Frequency Hz (Частота, Гц).
Tone Switch (Переключатель тона)	Нажмите, чтобы подать сигнал. На экране появится значок подачи сигнала (например,).
Hearing Level dB (Порог слышимости, дБ)	Вращайте регулятор для выбора громкости подаваемого тона.
Frequency Hz (Частота, Гц)	Вращайте регулятор для выбора частоты подаваемого тона.


Функциональные кнопки MA 25/MA 27

F1	F2	F3	F4
Выберите Right (Правое) ухо	Выберите Left (Левое) ухо	Pulse (Пульсирующий) Вкл./Выкл.	Warble (Трель) Вкл./Выкл.

Функциональные кнопки MA 25e/MA 27e

F1	F2	F3	F4
Переключение между Right (Правым) и Left (Левым)	Store (Сохранить) пороговое значение	Pulse (Пульсирующий) Вкл./Выкл.	Warble (Трель) Вкл./Выкл.

4. ДИСПЛЕЙ



Тон подается (включен).



Тон не подается (выключен).



Кнопка ответа пациента активирована (нажата).



Кнопка ответа пациента не активирована (не нажата).



Устройство подключено к источнику питания.



Если устройство питается от батарей, значок батареи изменяется в зависимости от уровня их заряда.



Если заряд батареи заканчивается, на экране отображается «**Низкий заряд батареи)Low
Ba**», и значок мигает.

5. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Чтобы перейти в меню настройки, одновременно нажмите клавиши F1 и F4 и удерживайте нажатыми 2–3 секунды.

F1	F2	F3	F4
Change (Изменение) настройки	Переход вверх (↑) в меню настройки	Переход вниз (↓) в меню настройки	Save (Сохранить) настройки и выйти из меню настройки

6. ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ MA 25e/МА 27e

- Микрофон оператора) Talk F:** Удерживайте нажатым регулятор **Порог слышимости, дБ)Hearin**, чтобы включить «Микрофон врача». Чтобы отрегулировать громкость микрофона врача, нажмите и вращайте регулятор **Порог слышимости, дБ)Hearin**.

Нажмите регулятор частоты, чтобы активизировать это меню.



- Специальные функциональные кнопки MA 25e/МА 27e:**

F1	F2	F3	F4
Delete (Удалить все) пороги слышимости, сохраненные на устройстве	Сохранение пороговой точки Not Heard (не слышно)	Отображение Threshold (порогов) слышимости, сохраненные на устройстве	Запуск автоматического теста Хьюсона- Вестлейка (HW)

- Передача данных на ПК** Для передачи данных на ПК необходима программа **MAICO Sessions**. Указания по надлежащей установке и передаче данных см. в инструкции по эксплуатации.